

Utilización del kit control de vía aérea i-gel® O₂

Preparaciones previas a la inserción



1 Elija el tamaño adecuado de i-gel O₂ utilizando la guía de tamaños del recuadro de la derecha.



2 Abra el embalaje y saque la bandeja interna, dejando la cinta de fijación, la sonda de aspiración y el sobre de lubricante a un lado. Saque la cánula i-gel O₂.



3 Abra el sobre de lubricante y ponga una pequeña cantidad sobre la superficie lisa del envase principal.



4 Lubrique la parte posterior, los laterales y la parte delantera de la almohadilla con una fina capa de lubricante. (Asegúrese de eliminar cualquier exceso de lubricante antes de la inserción)


Técnica de inserción




5 Agarre firmemente i-gel O₂ por la pieza de mordida integrada, coloque al paciente en posición de "olfateo" (a menos que esté contraindicado) con la cabeza extendida y el cuello flexionado.



6 Posicione el dispositivo de manera que la salida del canal ventilatorio mire hacia el paciente. Introduzca la punta suave en la boca del paciente en dirección hacia el paladar duro.

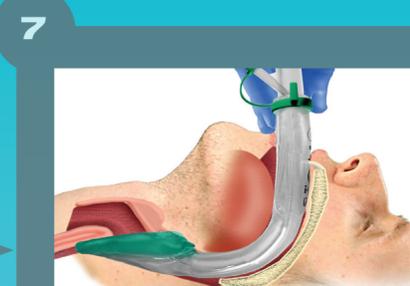

7 Deslice el dispositivo hacia abajo y hacia atrás a lo largo del paladar duro empujando de forma suave pero continua hasta percibir una resistencia firme.

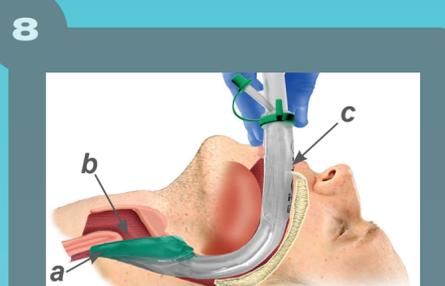

8 La punta de la cánula debería localizarse en la apertura esofágica superior (a) y la almohadilla debería localizarse frente a la estructura laríngea (b). Los incisivos deberían descansar sobre la pieza de mordida integrada (c).



9 Asegure el dispositivo deslizando la cinta de fijación por debajo del cuello del paciente y enganchándola al anillo de fijación. Tenga cuidado de no poner la cinta demasiado tirante.



Alternativamente, se puede fijar el dispositivo con adhesivo de "maxilar a maxilar".**



10 Ahora que i-gel O₂ se ha preparado, insertado y asegurado correctamente, puede empezar a aplicar la ventilación con presión positiva de acuerdo a las técnicas de resucitación aplicables.**

Tamaño i-gel O ₂	Paciente	Guía de pesos recomendados (kg)
3	Adulto pequeño	30-60
4	Adulto mediano	50-90
5	Adulto grande	90+



Notas a la técnica de inserción:

Se puede insertar en menos de **5 segundos**.

A veces se puede percibir una sensación de resistencia antes de alcanzar el punto final. Esto se debe al paso de la almohadilla de i-gel O₂ a través de los pilares fauciales. Es importante que se continúe con la inserción hasta que se note una **resistencia firme**.

Una vez conseguida la correcta inserción y los dientes se localizan sobre la pieza de mordida, **no** empuje la cánula repetidamente hacia abajo ni aplique fuerza excesiva durante la inserción.

No deben hacerse más de tres intentos por paciente.

No es necesario introducir los dedos ni pulgares en la boca del paciente durante el proceso de inserción del dispositivo.

www.i-gel.com/igel-o2-resus

T: +34 91 665 73 15

mail@intersurgical-es.com

* Estas instrucciones NO constituyen una guía completa para la preparación, inserción y uso de i-gel O₂. El usuario deberá familiarizarse previamente con el manual de usuario completo antes de intentar usar i-gel O₂.

** i-gel O₂ ha sido diseñada para facilitar la ventilación como parte de los protocolos de resucitación estándar, tales como los designados por el Consejo Europeo de Resucitación (ERC) y la Asociación Americana del Corazón (AHA). Sin embargo, i-gel O₂ incorpora un puerto suplementario de oxígeno, por lo que también se puede utilizar para administrar oxigenación pasiva, o Manejo de Vía Aérea Pasiva (PAM), como parte de un protocolo de reanimación cardiocerebral (CCR). Para obtener más información sobre la oxigenación pasiva, por favor, consulte las instrucciones de uso o póngase en contacto con nosotros. Pueden disponer de copias del manual poniéndose en contacto con Intersurgical o a través de nuestra página web: www.i-gel.com